


CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL	
04.026.757/0001-05	OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP	R\$ 379,70	
<b>Marca:</b> MEDTEC <b>Fabricante:</b> MEDTEC <b>Modelo:</b> MED300 <b>Descrição:</b> Aplicação em Larga Escala. Rápida tomada de temperatura. Medições precisas sem contato. Design moderno. Visor digital luminoso. ESPECIFICAÇÕES: Faixa de Temperatura: -50 a 420oC (-58 a 788oF) Precisão: (-50 a 0 oC) +/- 2 oC - (0 a 420 oC) +/- 1,5oC Distância razão do ponto: 12: 1 Emissividade: Fixe d Tempo de resposta e de comprimento de onda: 500ms Repetibilidade: 1% Resolução: 0.1 oC /oF Seleção Celsius / Fahrenheit: SIM Função Armazenamento de dados: SIM Mira Laser: SIM Função liga e desliga luz no display: SIM Função desligamento automático/ Economia de bateria: SIM Indicação de bateria fraca: Sim Características Gerais Alimentação: Bateria Alcalina 9 VDC (Não inclusa) Desligamento automático após 7 segundos fora de uso Temperatura de armazenagem -20 a 60oC / Temperatura de trabalho 0 a 40oC Vida útil da bateria em uso contínuo - 168-240 horas Cor do produto: Laranja e Preto Dimensões: 88 x 42 x 175 mm (L x P x A).			
<b>Endereço:</b> R GETULIO VARGAS, 351	<b>Nome de Contato:</b> SANDRA	<b>Telefone:</b> (43) 3262-2979	<b>Email:</b> oficio2papelaria@gmail.com
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 448,00	
<b>Marca:</b> Noan <b>Fabricante:</b> Zhangye City Noan Medical Devices Co. Ltd <b>Modelo:</b> T-001 <b>Descrição:</b> Termômetro digital de testa infravermelho laser Especificações Mínimas: Largura: 8,0cm x Altura: 14,0cm Faixa de temperatura: -50 ~380°C (-58 ~ 716°F) Precisão: +- 1,5°C/ +- 1,5% Resolução: 0.1°C ou 0.1°F Distância razão do ponto: 12: 1 Unidade seleção Celsius °C e Fahrenheit °F Função de retenção de dados Desligamento automático e retenção de dados Laser e Luz de fund ON/OFF selecionável Bateria de 1.5V AAA Garantia			
<b>Endereço:</b> ROD DOS MINERIOS, 403	<b>Telefone:</b> (41) 3699-4237	<b>Email:</b> asclepioshospitales@uol.com.br	
04.360.651/0001-43	ANA MARIA PIRES BELEM - ME	R\$ 449,20	
<b>Marca:</b> Bo Hui <b>Fabricante:</b> Bo Hui <b>Modelo:</b> Bo Hui <b>Descrição:</b> Termômetro digital de testa infravermelho laser Especificações Mínimas: Largura: 8,0cm x Altura: 14,0cm Faixa de temperatura: -50 ~380°C (-58 ~ 716°F) Precisão: +- 1,5°C/ +- 1,5% Resolução: 0.1°C ou 0.1°F Distância razão do ponto: 12: 1 Unidade seleção Celsius °C e Fahrenheit °F Função de retenção de dados Desligamento automático e retenção de dados Laser e Luz de fund ON/OFF selecionável Bateria de 1.5V AAA Garantia			
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Porto Alegre	<b>Endereço:</b> AVENIDA PADRE CACIQUE, 40	<b>Telefone:</b> (51) 3228-8073
18.031.325/0001-05	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	R\$ 549,00	
<b>Marca:</b> TOTH <b>Fabricante:</b> TOTH <b>Modelo:</b> TD-1242 <b>Descrição:</b> Aplicações: hospitalar Tipo de medição: sem contacto Zona de medição: frontal Faixa de temperatura: MÁX: 43 °C (109,4 °F) MÍN: 32 °C (89,6 °F) NonContacto(3~6cm) Termômetro de testa &#65294;3 modos de medição : Adultos / Crianças / Temperatura Superficial(0~100°C) &#65294;One Medição por Toque: Resultados rápidos e precisos em um segundo &#65294;Data Armazenamento: Armazena até 30 leituras para fácil recuperação &#65294;Fever Indica or. Alarme de Alta Temperatura com Luz de Fundo Flash &#65294;Temperature é dado em Fahrenheit ou Celsius. UnitPcs N.W.6.7 Kgs G.W.8.0 Kgs Dim.38.2(L)*32.1(W)*35.2(H) cm TTL CTN.250			
<b>Endereço:</b> AV BERNARDO SAYAO, 785	<b>Nome de Contato:</b> COSTA	<b>Telefone:</b> (62) 98407-9446	<b>Email:</b> seixascosta@hotmail.com
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 550,00	
<b>Marca:</b> THERMOMETHER <b>Fabricante:</b> THERMOMETHER <b>Modelo:</b> GP 300 <b>Descrição:</b> Termômetro digital de testa infravermelho laser Termômetro digital de testa infravermelho laser Especificações Mínimas: Largura: 8,0cm x Altura: 14,0cm Faixa de temperatura: -50 ~380°C (-58 ~716°F) Precisão: +- 1,5°C/ +- 1,5% Resolução: 0.1°C ou 0.1°F Distância razão do ponto: 12: 1 Unidade seleção Celsius °C e Fahrenheit °F Função de retenção de dados Desligamento automático e retenção de dados Laser e Luz de fund ON/OFF selecionável Bateria de 1.5V AA Garantia			
<b>Endereço:</b> AV HENRIQUE MANSANO, 1595	<b>Telefone:</b> (43) 3339-1320	<b>Email:</b> londrimedihospitalar@gmail.com	
28.044.340/0001-33	FERNANDA MOTTA TORRES	R\$ 550,75	
<b>Marca:</b> Gtech <b>Fabricante:</b> Gtech <b>Modelo:</b> Infravermelho <b>Descrição:</b> Touch free 3:1 com 1 ano de garantia			
<b>Endereço:</b> R TENENTE UBALDO, 227	<b>Telefone:</b> (43) 9672-9318	<b>Email:</b> contabeistmz@hotmail.com	

**Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 288,95

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR  
**Objeto:** Aquisição(ões) de Material Hospitalar, Odontológico, Fisioterapêutico e afins para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Maripá/PR..  
**Descrição:** **TERMÔMETRO - TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-30 °C A +500 °C, APLICAÇÃO VISOR RETROILUMINADO, MATERIAL EMISSIVIDADE FIXA DE 0,95, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTATO MIRA LASER (INFRAVERMELHO)**

**Data:** 01/06/2020 08:02  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:362020 / UASG:98548  
**Lote/Item:** /409  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 25  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PR

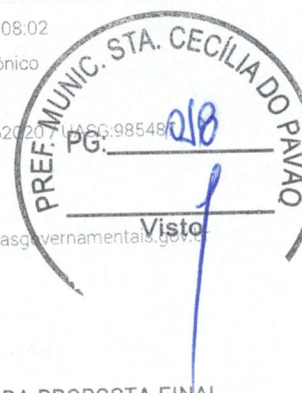

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA. - EPP * VENCEDOR *	R\$ 288,92		
<b>Marca:</b> INSTRUTHERM <b>Fabricante:</b> INSTRUTHERM <b>Modelo:</b> TI-550 <b>Descrição:</b> TERMÔMETRO DIGITAL PORTATIL INFRAVERMELHO A LASER ESCALA -50 A 550°C Especificações Display: Cristal líquido (LCD) de 3 dígitos (2005 contagens) com iluminação Escala: -50°C ~ 550°C / -58°F ~ 1022°F Precisão: ±3°C/±5°F (na faixa de -50°C~0°C) / ±1,5°C + 1,5% (na faixa de 0~550°C) Resolução: 0,1°C; Indicador de sobre escala Taxa de amostragem: 300 ms Indicação de sobre escala: O display exibe 1 Polaridade Automática: - para polaridade negativa, positiva omitida Emissividade ajustável Memória: máxima, mínima, média e diferencial Alarme alto e baixo Ajuste de ponto zero Coeficiente de distância: 12 1 Laser: Classe 2 1mW com forma de onda de 630 ~ 670 nm Resposta espectral: 6 ~ 14m Desligamento automático: Após 7 segundos aproximadamente Temperatura de operação: 0 ~ 50°C Temperatura de armazenagem: -20 ~ 60°C Umidade de operação: 10 ~ 90% RH Umidade de armazenagem: < 80% RH Indicador de bateria fraca Alimentação: 1 bateria de 9V Dimensões: 101 x 43 x 153 mm Peso: 147,5g Duração da bateria: Aproximadamente 10 horas Consumo de corrente em repouso: Aproximadamente 5A Medições precisas, sem contato Mira laser incorporada Seleção de escala e resolução automática Botão de seleção °C / °F DATA-HOLD e desligamento automáticos Display LCD com iluminação Certificado de calibração				
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>Endereço:</b> R SOUSA FILHO, 667	<b>Telefone:</b> (11) 4304-7800	<b>Email:</b> aiq@aiq.com.br

30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R\$ 288,95	
<b>Marca:</b> FORMIS <b>Fabricante:</b> FORMIS <b>Modelo:</b> FOR-550 <b>Descrição:</b> TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-30 °C A +500 °C, APLICAÇÃO VISOR RETROILUMINADO, MATERIAL EMISSIVIDADE E FIXA DE 0,95, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTATO MIRA LASER (INFRAVERMELHO)			
<b>Endereço:</b> R CARDEAL (P LARANJEIRAS), 640	<b>Nome de Contato:</b> GUILHERME	<b>Telefone:</b> (11) 4441-8838	<b>Email:</b> formis@formis.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 450,00

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar do Sudeste  
 2ª Divisão de Exército  
 11ª Brigada de Infantaria Blindada

**Objeto:** O objeto da licitação é o registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos, aparelhos e materiais permanentes médico-odontológicos diversos, para atender as necessidades do Posto Médico da Guarnição de Campinas (PMGuCas) do Comando da 11ª Bda Inf L, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

**Descrição:** **TERMÔMETRO - TERMÔMETRO, TIPO LASER DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-50 A 380 °C, APLICAÇÃO EFETUAR MEDIÇÕES EM LUGARES DE DIFÍCIL ALCANCE, ELEMENTO EXPANSÃO INFRAVERMELHO, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIRA LASER CLASSE II; DISTÂNCIA DO FOCO DE 50:1, PRECISÃO +/- 1 °C, ALIMENTAÇÃO BATERIA/ PILHA**

**Data:** 28/05/2020 10:07  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:62020 / UASG:160466  
**Lote/Item:** /21  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 10  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

23.015.239/0001-30 SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI  
\* VENCEDOR \*

R\$ 200,00

**Marca:** BIOLAND  
**Fabricante:** BIOLAND

**Modelo:** TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO


**Descrição:** TERMÔMETRO DIGITAL MEDIDOR DE TEMPERATURA CORPORAL VIA INFRAVERMELHO: Amplitude da medição corporal: 32°C ~ 42,5°C (90°F ~ 108,5°F); - Precisão/Margem: +/- 0,2°C (0,36°F); - Distância de medição: 5cm ~ 15cm; - Tempo de resposta: 0,5 (meio) segundo; - Temperatura que opera: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F); - Temperatura de armazenamento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F); - Humidade a que opera: = 85%; - Amplitude da medição de superfície: 0°C ~ 100°C (32°F ~ 212°F); - Desligamento automático após 13 segundos; - Alimentação: 2 pilhas AAA (palito) DC 3V (inclusas).

**Endereço:**  
R BRASÍLIO MACHADO, 261

**Nome de Contato:**  
FERNANDO

**Telefone:**  
(45) 3231-8010

**Email:**  
licitacao@ispsaude.com.br

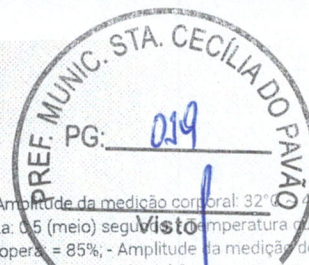

19.031.878/0001-12 AUTOMX SOLUCOES EIRELI - ME

R\$ 450,00

**Marca:** FAST  
**Fabricante:** FATS  
**Modelo:** BKR6

**Descrição:** TERMÔMETRO DIGITAL MEDIDOR DE TEMPERATURA CORPORAL VIA INFRAVERMELHO: Amplitude da medição corporal: 32°C ~ 42,5°C - Precisão/Margem: +/- 0,2°C (0,36°F); - Distância de medição: 5cm ~ 15cm; - Tempo de resposta: 0,5 (meio) segundo; - Temperatura que opera: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F); - Temperatura de armazenamento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F); - Humidade a que opera: = 85%; - Amplitude da medição de superfície: 0°C ~ 100°C (32°F ~ 212°F); - Desligamento automático após 13 segundos; - Alimentação: 2 pilhas AAA (palito) DC 3V (inclusas).

**Endereço:**  
R DOUTOR DANTE GLAUCUS DELEO, 16

**Nome de Contato:**  
Edison Yoshio Mitsumoto

**Telefone:**  
(11) 4229-7900

**Email:**  
autom@autom.ind.br

27.602.134/0001-39 HEALTH SANTA LUZIA LTDA

R\$ 1.000,00

**Marca:** G TECH  
**Fabricante:** G TECH  
**Modelo:** G TECH

**Descrição:** Termômetro Digital Medidor De Temperatura Corporal Via Infravermelho: Amplitude da medição corporal: 32°C ~ 42,5°C (90°F ~ 108,5°F); - Precisão/Margem: +/- 0,2°C (0,36°F); - Distância de medição: 5cm ~ 15cm; - Tempo de resposta: 0,5 (meio) segundo; - Temperatura que opera: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F); - Temperatura de armazenamento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F); - Humidade a que opera: = 85%; - Amplitude da medição de superfície: 0°C ~ 100°C (32°F ~ 212°F); - Desligamento automático após 13 segundos; - Alimentação: 2 pilhas AAA (palito) DC 3V (inclusas).

**Endereço:**  
AVENIDA RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO, 940

**Telefone:**  
(31) 3642-1205

**Email:**  
contato@healthsantaluzia.com.br





(index.html)

Nota Paraná O que é Dúvidas Frequentes  
(http://www.nota(parana).pr.gov.br/faq)

Entrar

LONDRINA

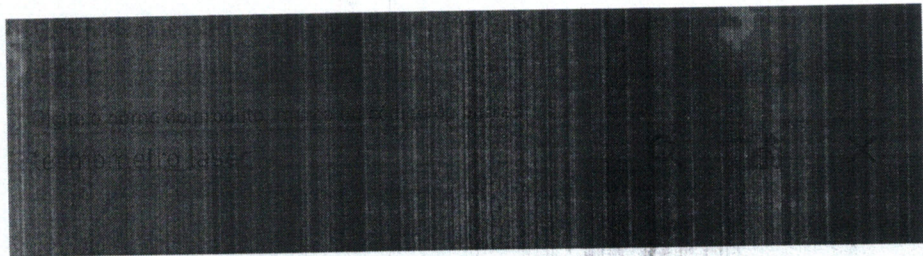

Produtos

R\$ 560,00



TERMOMETRO LASER AIQURA

MAX CENTER ORTOPEDICA

📍 1,68 Km 📅 há um dia



R\$ 560,00



TERMOMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO

LASER TERM T8

CASA MEDICA-COMERCIO DE PRODUTOS


HOSPITALARES LTDA - ME

📍 2,06 Km 📅 há 14 dias





Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

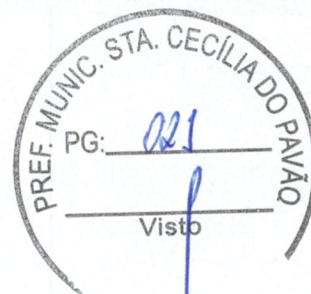

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 022139413-05

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **06.175.908/0001-12**  
Nome: **BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 22/10/2020 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.175.908/0001-12

**Razão Social:** BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

**Endereço:** R PROFESSORA ZELDA C. CURSI MASTRIANI 265 A / JARDIM DAVILA /  
CAMBE / PR / 86182-530

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/03/2020 a 18/07/2020

**Certificação Número:** 2020032104450866612300

Informação obtida em 24/06/2020 14:26:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI**  
**CNPJ: 06.175.908/0001-12**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:29:01 do dia 19/06/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/12/2020.

Código de controle da certidão: **5AB6.6893.3669.4344**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 06.175.908/0001-12  
Certidão nº: 14689225/2020  
Expedição: 24/06/2020, às 14:28:34  
Validade: 20/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.175.908/0001-12**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.